DOCTORAIR

取扱説明書

エクサガンハイパー オリジナルベルト

EXAGUN HYPER ORIGINAL BELT / REG-04BLT




このたびはドクターエア製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。


- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。

各部の名称


本体

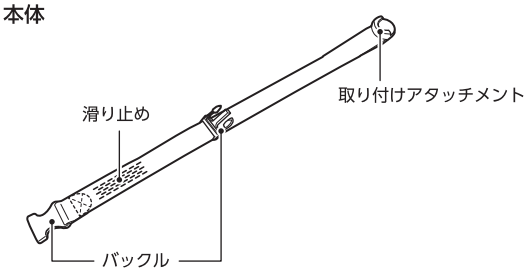

付属品



三角形アタッチメント×4



ポーチ




取扱説明書
(保証書付き)

使用上のご注意

- 本製品は、別売品エクサガンハイパー（REG-04）の専用ベルトのため、その他の製品に使用しない。
- 使用する前に、本書及びエクサガンハイパーの取扱説明書を必ず読む。
- 首の周辺に使用する際は特に注意し、首に巻き付けて使用しない。（ケガや思わぬ事故の原因）
- 金属やシリコン、プラスチックを埋め込んだ部位に使用しない。（ケガの原因）
- 使用する前に、必ず本製品及びエクサガンハイパー本体に異常がないか確認し、異常や破損などがある場合は使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口まで相談する。
- お手入れの際は、必ず本製品をエクサガンハイパー本体から取り外してから行う。（故障の原因）
- アタッチメントを取り外す際は、必ずエクサガンハイパーの振動を停止した状態で行う。
- 汚れが付いた際は、水または希釈した中性洗剤で濡らしてかたく絞ったスポンジや、やわらかい布でふき取る。
  その後、乾いた布で乾拭きする。また、シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しない。
- ご使用にならないときは、汚れやほこりが付着しないよう、ポーチに入れて保管する。
- 保管の際は、乳幼児、小さなお子様の手の届く場所やペットが触れる場所、水場や湿気の多い場所、火のそば、直射日光の当たる場所などの高温環境下は保管しない。
- ご不要になった場合は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分する。条例の詳しい内容は、各地方自治体に確認する。

使用する


1 取り付けアタッチメント側の面ファスナーを引っ張りながら、お好みの長さに調整する。

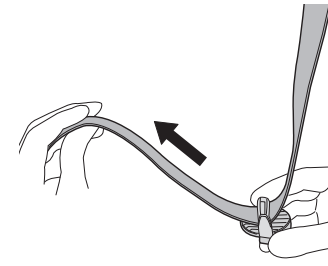

2 お好みで面ファスナーに三角形アタッチメントを取り付けて使用する。

※ベルトのみでもご使用いただけます。


※ケアしたい箇所に三角形アタッチメントを置くことをおすすめします。

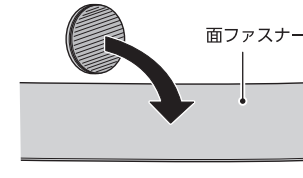


3 使用部位に当てる。

①ベルトを体に巻き付ける。


滑り止めを体に向けるように体に巻き、バックルをとめる。バックルをおさえ、ベルトを引っ張りながら締め付ける。

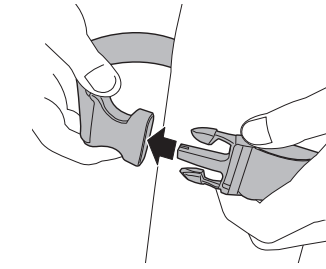

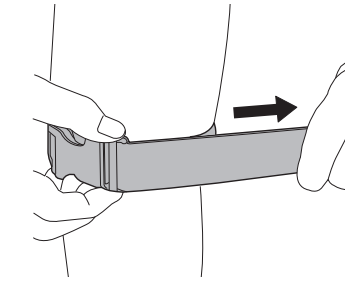


ベルトを体に添わせるように巻き付ける。

※ベルトの巻き付けがゆるいと、振動の伝わりが弱くなる可能性がありますので、しっかり巻き付けてください。

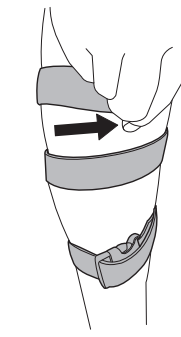


②ベルトを両手で持ち使用する。

バックルをとめて、イラストのようにベルトで持ち手を作る。

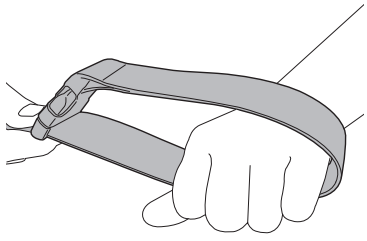

4 ベルトの取り付けアタッチメントを、エクサガンハイパーのフラットヘッドに力強くスライドさせてかぶせる。

※ベルトと本体がしっかり取り付けられているかを、引っ張りながら確認してください。

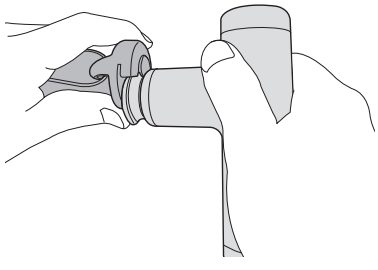


5 エクサガンハイパーを電源オンにする。


※ご使用の際は、エクサガンハイパーの本体から手を離さないでください。

※エクサガンハイパーの本体とベルトを体から離したり、振動レベルを上げると、カタカタ音がする場合があります。
異常ではありません。


ヒント


ベルトを、イラストのようにエクサガンハイパーの本体と並行にピンとしっかり伸ばすことで、よりベルトに振動が伝わりやすくなります。

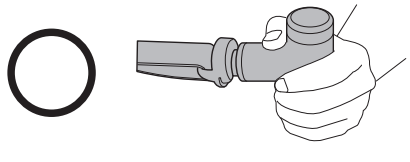


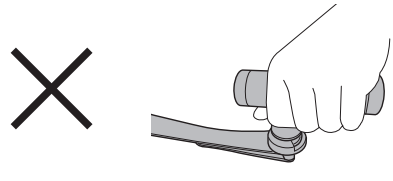


おすすめの使い方

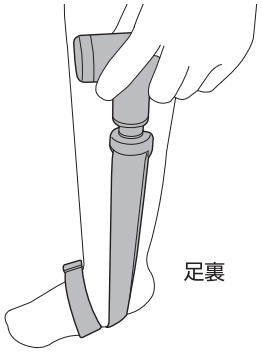

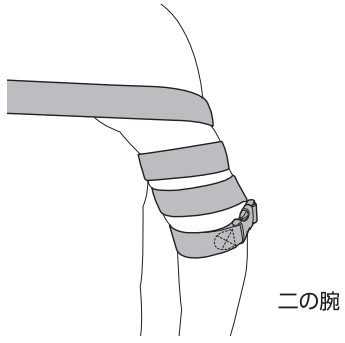

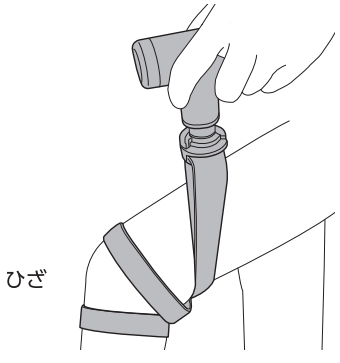

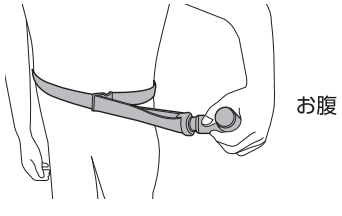



主な仕様

製品名	エクサガンハイパー オリジナルベルト
型番	REG-04BLT
外形寸法	約W1370×H30×D2.3mm (装着用バックルを含む)
質量	約70g（三角形アタッチメントを含まず）
材質	PA＋30%GF（バックル）、 PC（取り付けアタッチメント）、 シリコン（三角形アタッチメント）、 PA 織布（ベルト）、ポリエステル（巾着袋）
同梱物	三角形アタッチメント×4、ポーチ、 取扱説明書
生産国	中国